

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ

ООО «НТЦ «Фотометрия»

Экземпляр 1 из 2



А.В. Овчинников

подпись

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 026-20-св от 28 января 2020 г.
на 6 листах

Результаты испытаний, представленные в настоящем протоколе,
распространяются только на образец, прошедший испытания.

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Любая публикация или частичное воспроизведение содержания протокола запрещается без письменного
разрешения ООО «НТЦ «Фотометрия».

1. Аккредитованное лицо:

Полное наименование: Испытательная лаборатория Общества с ограниченной
ответственностью «Научно-технический центр «Фотометрия»
Сокращенное наименование: ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия»
Адрес: 127521, г. Москва, Анненский проезд, д.3, стр.1
Аттестат аккредитации: RA.RU.21ГГ01
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице: 14.07.2015 г.

2. Заказчик:

Наименование организации: ООО «Орион»
Адрес: 143005, Московская область, Одинцовский район, город
Одинцово, Можайское шоссе, дом 806, 2
этаж, комната 2136
Телефон: 8 (495) 739-25-65

3. Основные сведения об образце:

Наименование образца: Проектор светодиодный
Тип или модель: LPR-061-0-65K-050
Заводской номер (зав.№): б/н
Условный номер (усл.№): 20-014
Напряжение электропитания, В: 180-265
Частота электропитания, Гц: 50/60

4. Изготовитель:

Наименование организации: АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД.
Адрес: КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит,
Нос Боаличэн Билдинг, рум 901
Телефон: не указан

5. Документация, представленная с образцом:

Руководство по эксплуатации (Паспорт)

6. Дата получения образца:

27 января 2020 г.

7. Дата проведения испытаний:

27 января 2020 г.

8. Место проведения испытаний:ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия»
127521, г. Москва, Анненский проезд, д.3, стр.1**9. Сокращения, используемые в тексте протокола:**

б/н - без номера

10. Процедура испытаний.**10.1. Условия проведения испытаний:**

температура окружающего воздуха	25,04 °С;
относительная влажность воздуха	46,4 %;
атмосферное давление	98,97 кПа;
напряжение электропитания	230,03 В;
частота электропитания	49,997 Гц.

10.2. Цель испытаний:

Проведение светотехнических и электрических измерений согласно требованиям заказчика.

10.3. Программа испытаний:

Измерение:

распределение силы света, световой поток, световая отдача, потребляемая мощность, потребляемый ток, коррелированная цветовая температура, индекс цветопередачи, координаты цветности.

Построение диаграмм для меридиональных плоскостей.

10.4. Методы испытаний:

пп. 10.2, 10.3.2, 10.12, 10.13 ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

п. 5, приложение Б ГОСТ Р 55702-2013 «Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров»;

ГОСТ Р 55703-2013 «Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых характеристик» п. 7, приложение Е.

10.5. Нестандартные методы испытаний: Не использовались**10.6. Идентификация образца:**

Наименование, тип, маркировка и назначение образца соответствуют информации предоставленной заказчиком. Фотографии образца приведены в приложении 2.

10.7. Проверка работоспособности:

Работоспособность соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду образца.

10.8. Техническое описание образца:

Таблица 1

Напряжение электропитания, U_0 , В	Частота электропитания, f , Гц	Коэффициент мощности
230,03	49,997	0,9517

11. Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений.

Таблица 2

Наименование	Тип	Заводской номер	Инвентарный номер	Поверка (аттестация, калибровка) до
Установка для измерений силы света и его пространственного распределения	ГФУ-23	б/н	№ 0001	09.06.2021 г.
Двухкоординатный гониометр	ДГ-360	б/н	№ 0029	09.06.2021 г.
Фотодатчик (фотометрическая головка)	ГФ6-1	№ 1110	№ 0045	05.06.2020 г.
Измеритель мощности цифровой	WT310	№ C3RM30004E	№ 0151	22.08.2021 г.
Источник питания переменного тока	APS-9102	№ EO854009	№ 0150	26.11.2020 г.
Измеритель параметров микроклимата	Метеоскоп-М	№ 374619	№ 0155	21.04.2021 г.
Спектроколориметр	ТКА-ВД/2	№ 72050	№ 0097	26.12.2020 г.
Прибор комбинированный	еЛайт, исполнение 1 (еЛайт01)	еЛайт03 № 02057-16	№ 0149	18.09.2020 г.
		БОИ-01 №00745-16		



12. Результаты испытаний:

Результаты испытаний образца

Прожектор светодиодный LPR-061-0-65K-050, зав. №б/н, усл. №20-014

приведены в таблице 3 и в приложении 1.

Таблица 3

№ п/п	Название параметра, обозначение, ед. измерения		Результаты
1	Суммарный световой поток, Φ_{Σ} , лм		4 270
2	Коррелированная цветовая температура, $T_{ки0}$, К		6086
3	Индекс цветопередачи, R_{a0}		71
4	Координаты цветности	x	0,319
		y	0,348
5	Потребляемая мощность, P, Вт		47,913
6	Потребляемый ток, I, мА		218,88
7	Световая отдача светильника, η , лм/Вт		89,1
8	Имя IES файла		20-014.ies

Примечание 1:

$T_{ки0}$ - Коррелированная цветовая температура в направлении оптической оси осветительного прибора, К;

R_{a0} - Индекс цветопередачи в направлении оптической оси осветительного прибора.

Примечание 2:

Измерение распределения силы света проводилось в фотометрической системе $C\gamma$ согласно приложению Г ГОСТ Р 54350-2015 (см. рисунок 1).

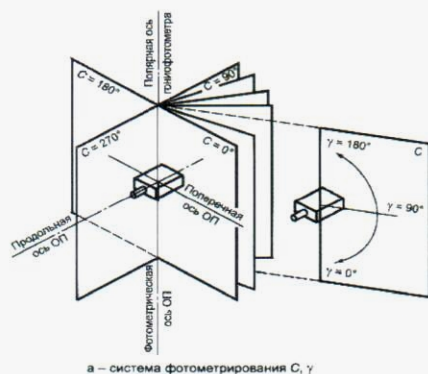


Рисунок 1. Фотометрическая система $C\gamma$


Испытания провел:
Инженер-испытатель

П.В. Старшинов П.В. Старшинов



Прожектор светодиодный LPR-061-0-65K-050, зав. №б/н, усл. №20-014

Диаграмма цветности x, y МКО-1931

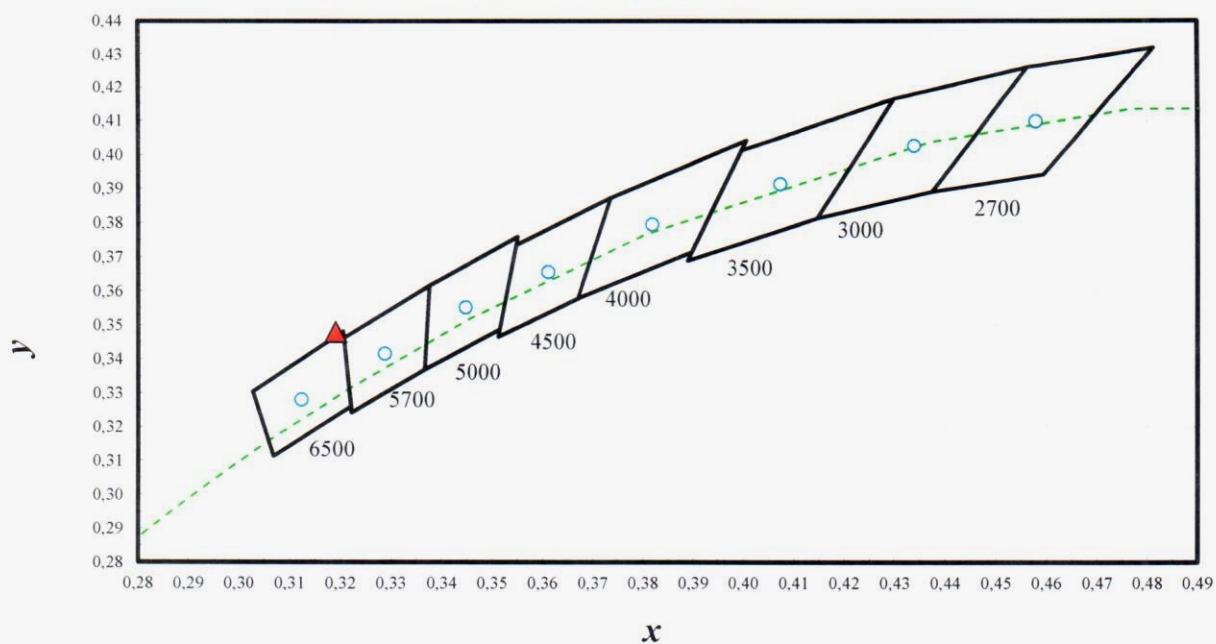

▲ Образец - - - Планка локус — Допустимые отклонения КЦТ ○ Ткц

Диаграмма пространственного распределения силы света образца в полярных координатах:


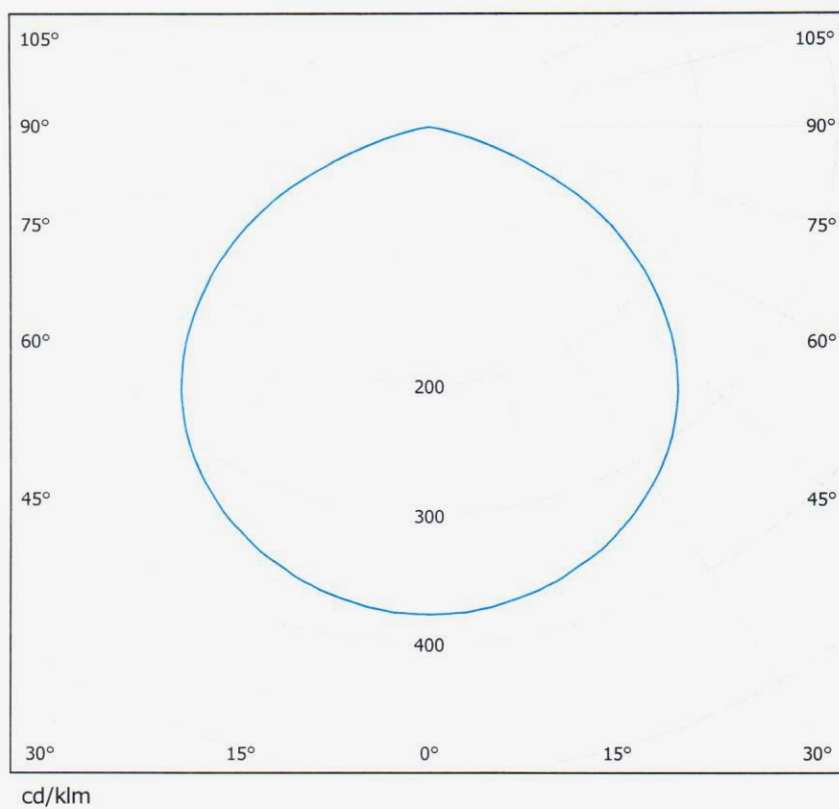


Диаграмма пространственного распределения силы света образца в декартовых координатах:



Фотографии образца

Прожектор светодиодный LPR-061-0-65K-050, зав. №б/н, усл. №20-014

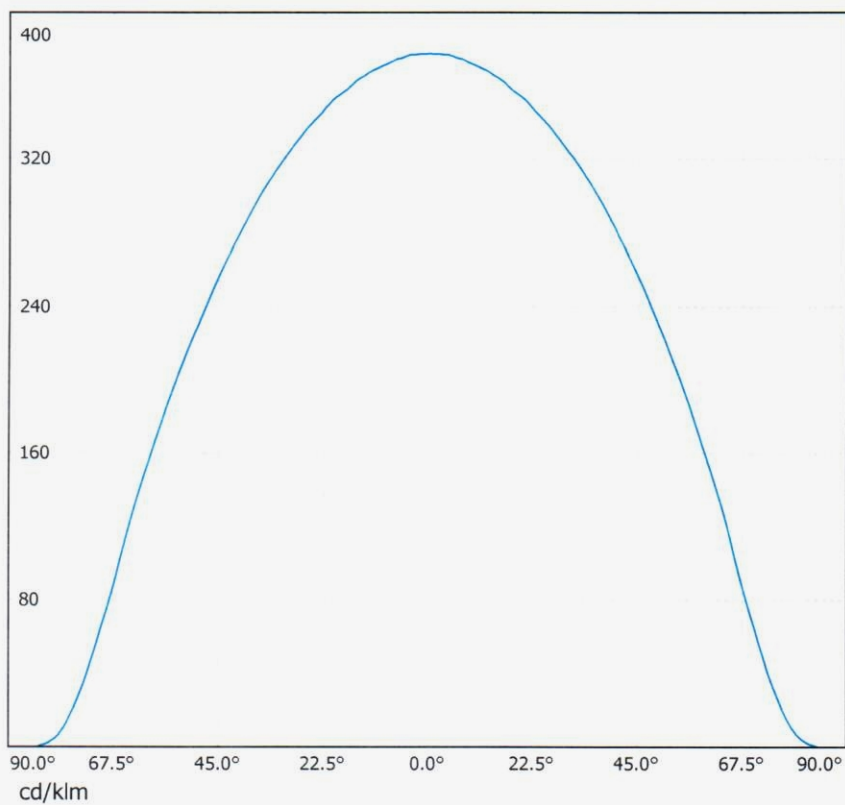

Фотография 1



Фотография 2



Фотография 3

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА